

N.º 223/CD
Data: 02/11/2011

Assunto: **Actualização da informação relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico *in vitro* MS4-3, MS9-3, MS9-3S, MS9-5S, M-SCAN II e M-Sampler**


Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

A autoridade competente francesa (AFSSAPS) retirou as medidas restritivas relativas aos analisadores de hematologia (**MS4-3, MS9-3, MS9-3S, MS9-5S**), analisadores de bioquímica (**M-SCAN II**) e aparelhos destinados a fazer a aspiração e processamento da amostra para uso em conjunto com o analisador de hematologia MS9 (**M-Sampler**) do fabricante **Melet Schloesing Laboratories** (França), divulgadas na [Circular Informativa nº 164/CD de 29/08/2011](#).

Atendendo às acções correctivas desencadeadas pelo fabricante Melet Schloesing Laboratories, a AFSSAPS considerou que os produtos já se encontram em conformidade com os requisitos legais, pelo que podem voltar a ser comercializados.

O Conselho Directivo

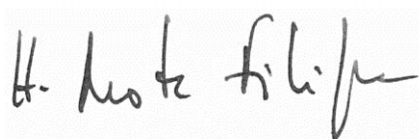

Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo